# **SNELGIDS** TURN ALL & PRESSURECARE

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

## TURN ALL
wisselligsysteem





**Let op: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.**

De zorgverleners die Turn All bedienen worden vooraf professioneel getraind door ATO of een geautoriseerde dealer. Alleen zij mogen Turn All bedienen. ATO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegd personeel.

















1. Zet het bed in de Fowler-positie met de rug en beenverstelling omhoog. Bevestig de 3 bevestigingsbanden van Turn All aan het beweegbare inlegraam om verschuiving te voorkomen.

2. Plaats de pomp aan het voeteneinde van het bed.

3. Koppel de luchtslang en stekker aan de pomp zonder knelpunten in de slang en steek de stekker in het stopcontact.

4. Leg het eigen matras over Turn All. Let erop dat dit een soepel matras is. Of maak gebruik van het matras vervangende Turn All PressureCare systeem.

### Zo schoon!

Door het matras komt Turn All normaalgesproken niet in aanraking met vocht waardoor deze dan alleen met een normale desinfectans gereinigd hoeft te worden aan de buitenkant.



**Geen Fowler-positie?**
Let er dan extra op dat de banden aan het beweegbare inlegraam vastgemaakt worden.
Hierdoor voorkomt men dat de banden scheuren wanneer een rugverstelling gebruikt wordt.


Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van Turn All

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl

TURN ALL SNELGIDS 08 - 2026

# **SNELGIDS** TURN ALL & PRESSURECARE

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

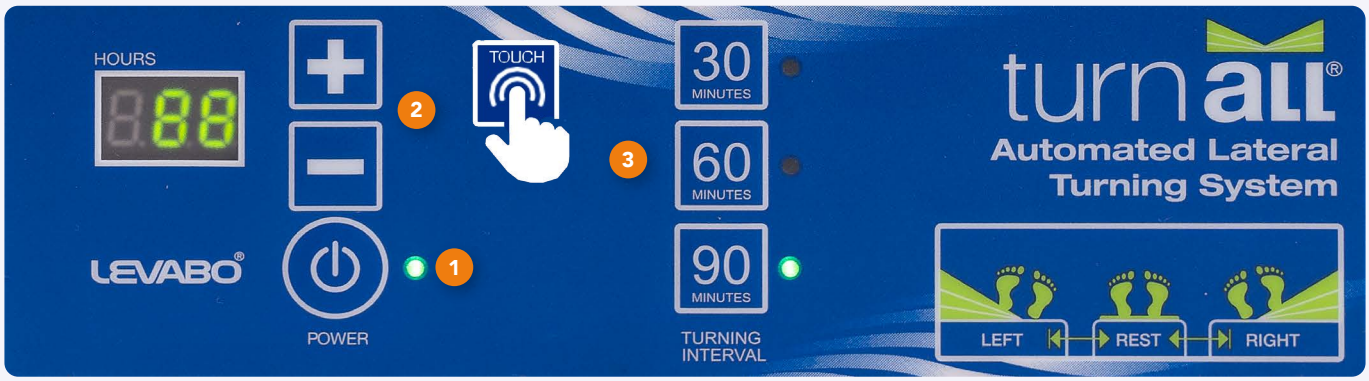



**1.** Aan / Uit-knop

Alle knoppen op de pomp zijn aanraakknoppen. Houd je vinger op de knop en de knop wordt geactiveerd.

**2.** Stel het gewenste aantal gebruikersuren in (maximaal 24 uur). Het systeem onthoudt deze instelling, zodat na het herstarten van de pomp de teller doorgaat vanaf het laatst ingestelde aantal uren.

**3.** Stel de gewenste draaicyclus in van 30, 60 of 90 minuten per zijde. De zorgvrager ligt gedurende die tijd op één kant, waarna het systeem binnen 5 tot 7 minuten naar de andere kant draait voor dezelfde duur.

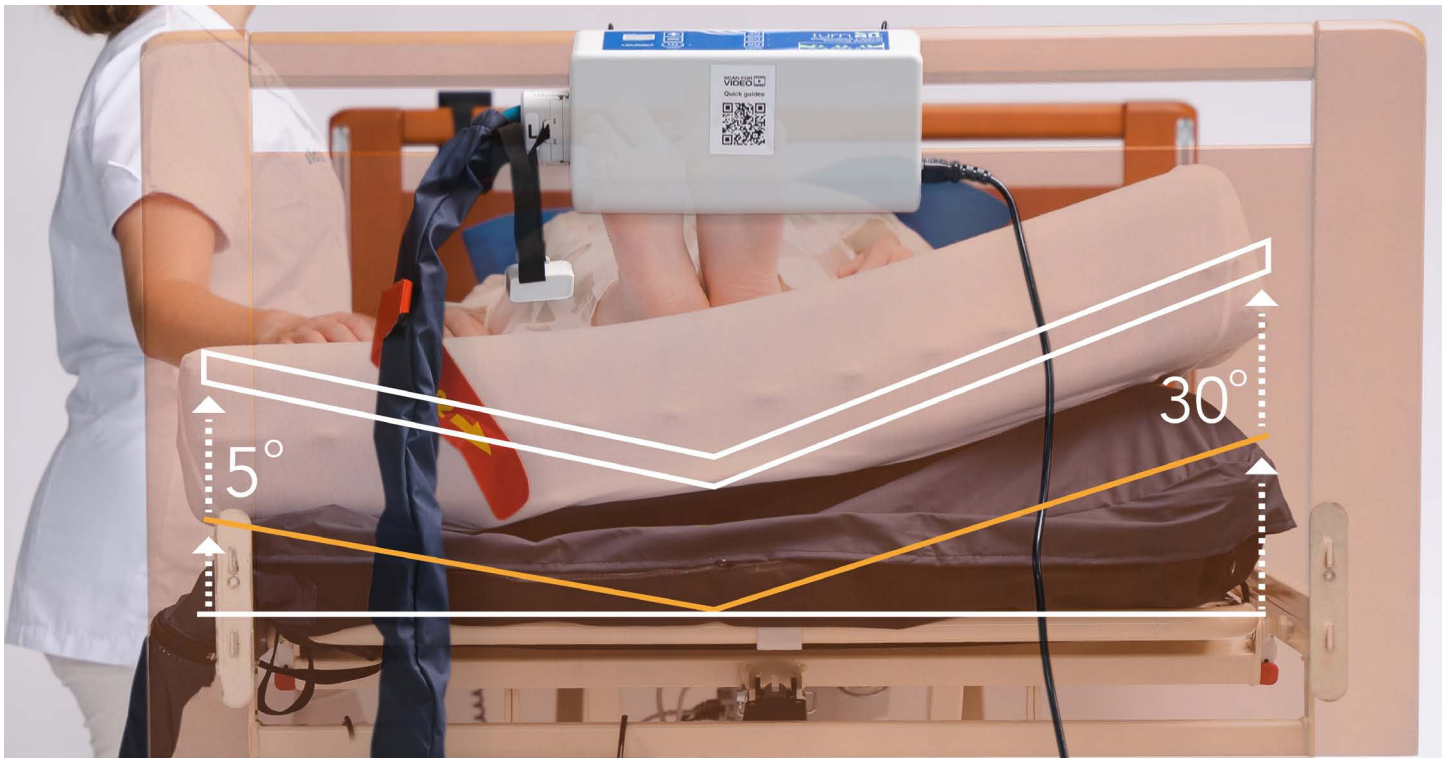


- Turn All kan worden gecombineerd met een wisseldruksysteem door Turn All eronder te plaatsen.

- Bij het uitschakelen van de pomp ontlucht het systeem binnen 2 minuten.

- Bij voorkeur bedhekken omhoog bij het gebruik van Turn All.

- Begint het systeem aan de verkeerde kant met oppompen? Schakel de pomp 3 seconden uit en weer in. Het systeem wisselt dan van startzijde en gaat verder met de ingestelde draaicyclus.

- CPR: Bij een medisch noodgeval koppel je de slangconnector los van de pomp. De luchtkamers lopen snel leeg. Drukken op het matras versnelt dit. Sluit daarna de slangconnector weer aan en start het systeem opnieuw op.

- Turn All is een mooi hulpmiddel, maar blijf altijd alert op wijzingen in de toestand en/of omstandigheden van de zorgvrager.